

Исследование рынка периферических внутривенных катетеров


Соотношение импорта и внутреннего производства инфузионных систем с иглами (в натуральном выражении)*

* Периферические внутривенные катетеры и иглы-бабочки в России не производятся

Динамика объема импорта и внутреннего производства инфузионных систем



Доля импорта и внутреннего производства в структуре потребления инфузионных систем

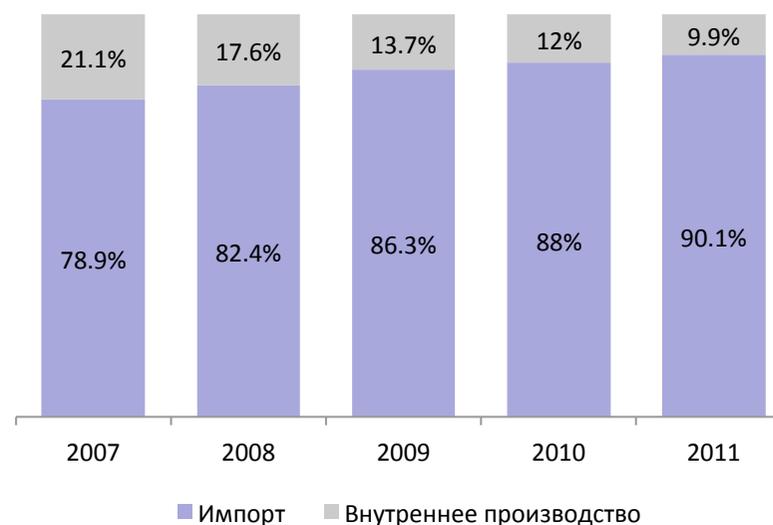


Источник: Данные ФТС РФ




Влияние пожеланий/требований отделений ЛПУ на закупку ПВК

Указание в заявке на закупку ПВК марки и производителя катетера

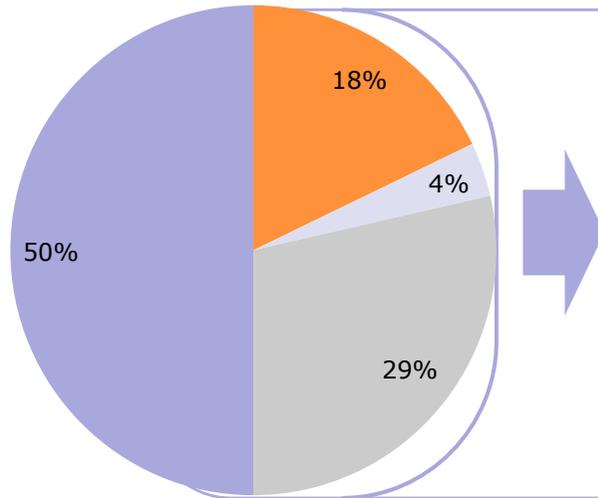

Удовлетворение пожеланий/требований отделений при закупках ПВК

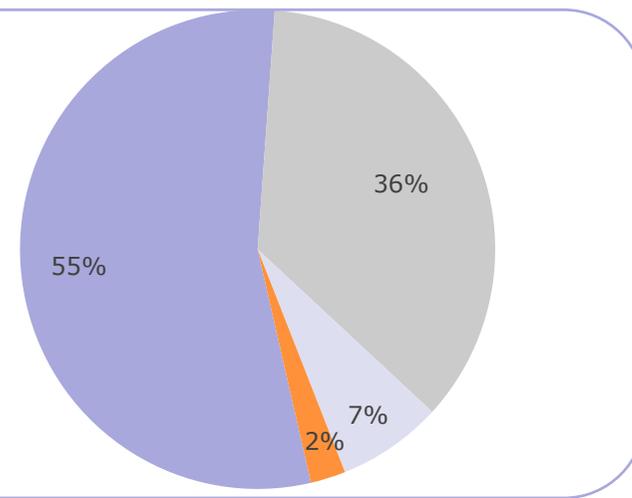

- В заявках указывается торговая марка
- В заявках указывается название производителя
- В заявках указывается и торговая марка, и название производителя
- В заявках НЕ указывается ни торговая марка, ни название производителя


- Закупки в соответствии с заявками отделений
- Заявки отделений удовлетворяются, но с внесением корректировок
- Производители и марки катетеров, указываемые отделениями не являются обязательными для закупки в ЛПУ
- Нет ответа

B26. Указывают ли отделения в своих заявках на ПВК желаемых производителей и конкретные торговые марки (наименования) катетеров?

B27. Учитываются ли в Вашем ЛПУ пожелания (требования) отделений относительно закупки ПВК конкретных производителей и торговых марок?



Оценка преимуществ и недостатков применения ИС с иглами и ПВК

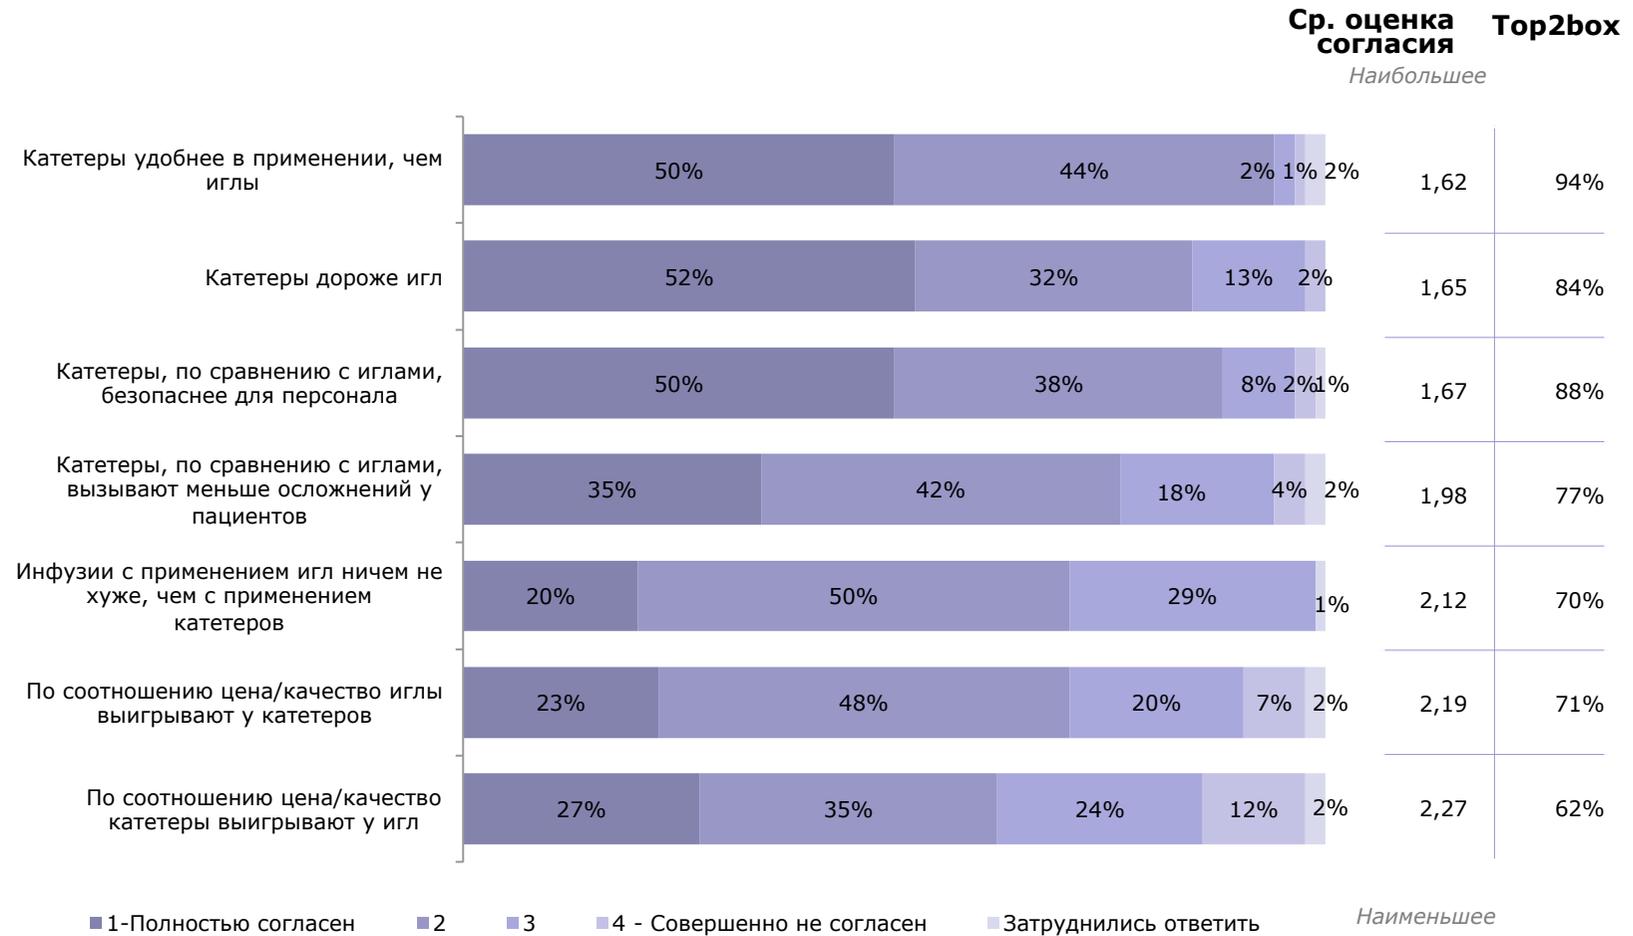

B25. Насколько Вы согласны со следующими высказываниями?

